Phonak Audéo™ I

Phonak Audéo I–Sphere (I90/I70/Trial)

Auricular S
Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida

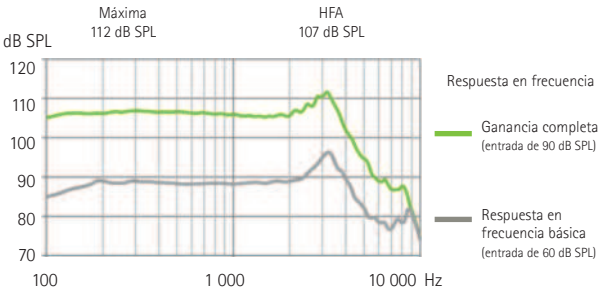

Ganancia acústica

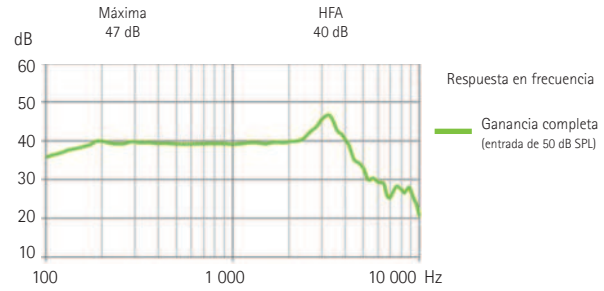

Rango de frecuencia	<100 Hz - 10 000 Hz				
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%	
Tiempo de funcionamiento esperado*	18 h				
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dB SPL				

Advertencias

⚠ Este audífono tiene un nivel de presión sonora de salida que puede superar los 132 dB SPL. Es necesario tener especial cuidado al acoplar este audífono ya que existe riesgo de reducir la audición residual del usuario.

⚠ No se permite realizar cambios ni modificaciones en el audífono sin que hayan sido aprobados explícitamente por el fabricante. Dichos cambios pueden dañar el oído o el audífono.

⚠ El SPL desarrollado en los oídos de los niños puede ser sustancialmente mayor que en los adultos medios. Se recomienda medir el RECD para corregir el objetivo del adaptador OSPL90.

Auricular M
Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida

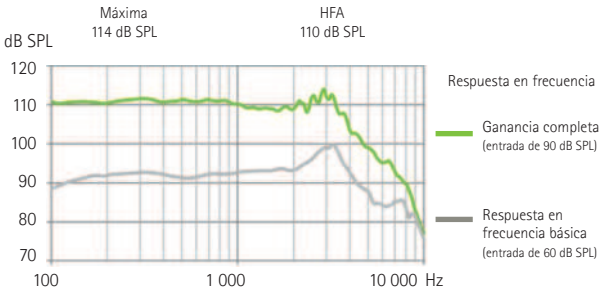

Ganancia acústica

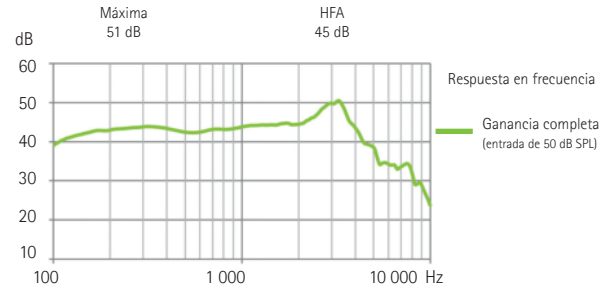

Rango de frecuencia	<100 Hz - 10 000 Hz				
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%	
Tiempo de funcionamiento esperado*	18 h				
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dB SPL				

* El tiempo de funcionamiento esperado de la batería recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la antigüedad de la batería y el ambiente sonoro.

V1.00/2024-01/ko © 2024 Sonova AG All rights reserved/página 1/3 TPL-953 [1]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

A Sonova brand

PHONAK life is on

Phonak Audéo™ I

Phonak Audéo I–Sphere (I90/I70/Trial)

Auricular MAV
Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida

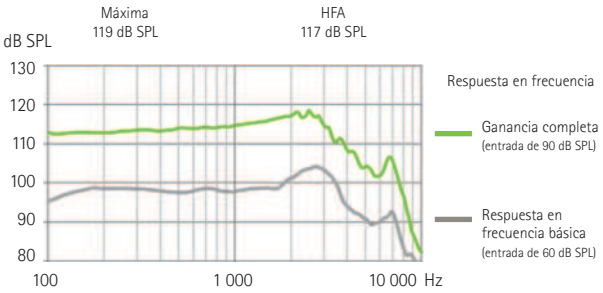

Ganancia acústica

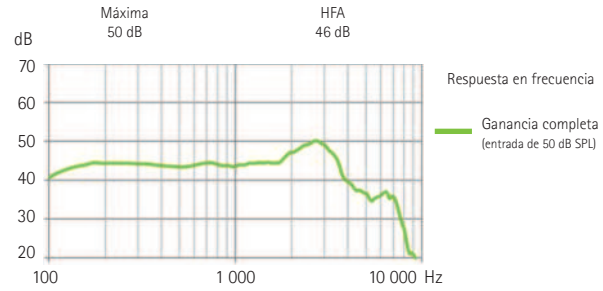

Rango de frecuencia	<100 Hz - 9 000 Hz				
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%	
Tiempo de funcionamiento esperado*	18 h				
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dB SPL				

Auricular P
Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida

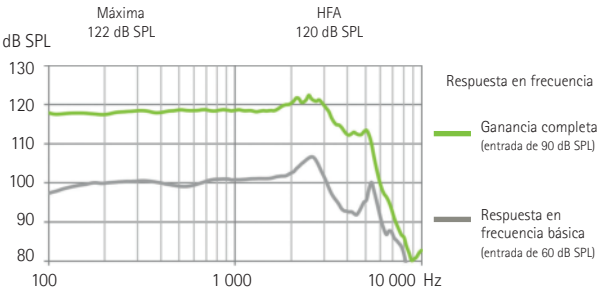

Ganancia acústica

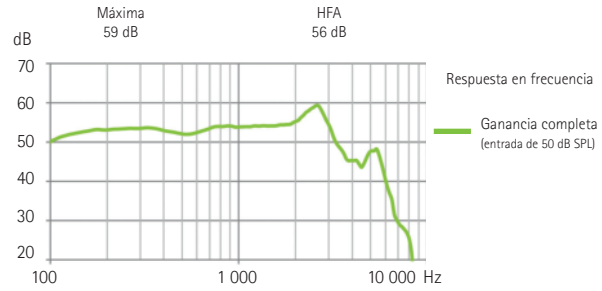

Rango de frecuencia	<100 Hz - 7 100 Hz				
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz	
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%	
Tiempo de funcionamiento esperado*	18 h				
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dB SPL				

Información general sobre la prueba

- Se utilizan ajustes de medición específicos. Ajuste RTS con control de volumen.
- El dispositivo está funcionando en el modo lineal.
- La expansión de nivel bajo está activa.
- Todos los datos obtenidos se miden con los ajustes de medición de Phonak Target.
- La latencia de la señal de audio determinada según un estándar interno es de 6,2 ms.

* El tiempo de funcionamiento esperado de la batería recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la antigüedad de la pila y el ambiente sonoro.

V1.00/2024-01/ko © 2024 Sonova AG All rights reserved/página 2/3 TPL-953 [1]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza
A Sonova brand
PHONAK life is on

Phonak Audéo™ I

Phonak Audéo I–Sphere (I90/I70/Trial)

Auricular UP
Datos de acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Nivel de presión sonora de salida

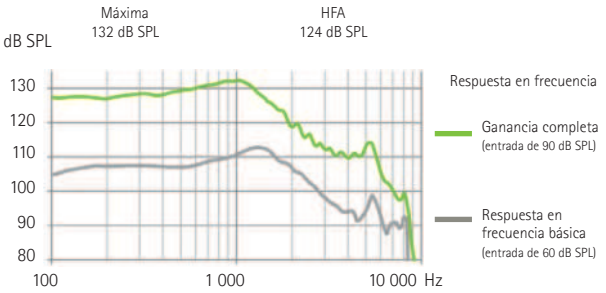

Ganancia acústica

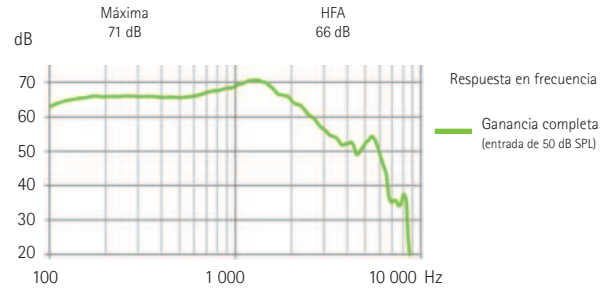

Rango de frecuencia	<100 Hz - 8 000 Hz			
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Tiempo de funcionamiento esperado*	18 h			
Nivel de entrada de ruido equivalente	19 dB SPL			

* El tiempo de funcionamiento esperado de la batería recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la antigüedad de la batería y el ambiente sonoro.

V1.00/2024-01/ko © 2024 Sonova AG All rights reserved/página 3/3 TPL-953 [1]

CE 0459
Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

PHONAK life is on