




Phonak Audéo P-R (P90/P70/P50/P30/Trial)


S-mottaker 2 cm³ koblingsdata

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Trykknivå for lydsignal

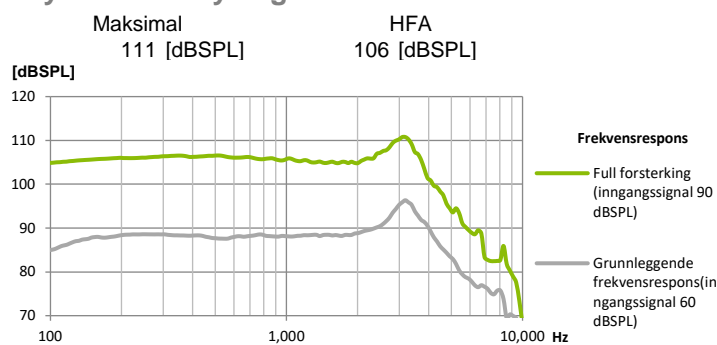

Lydforsterkning

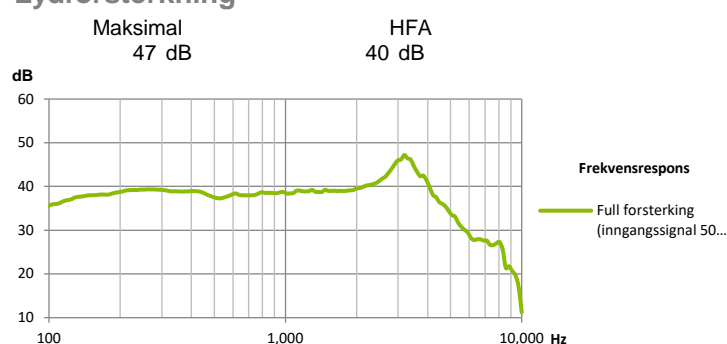


Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Forventet driftstid*	18 h			
Tilsvarende tilført støynivå	19 [dB SPL]			


M-mottaker 2 cm³ koblingsdata

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Trykknivå for lydsignal

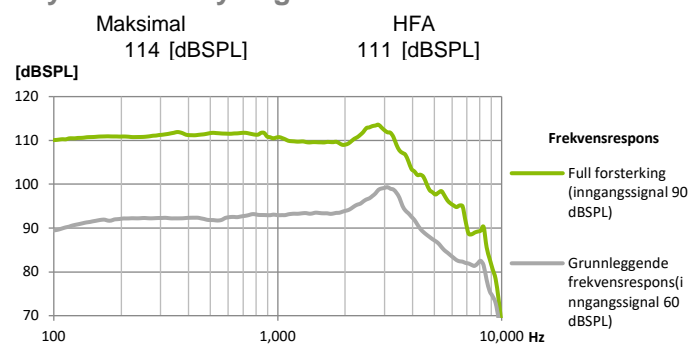

Lydforsterkning

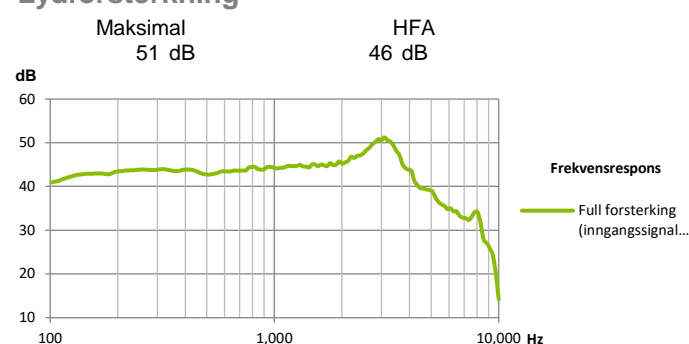

Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Forventet driftstid*	18 h			
Tilsvarende tilført støynivå	19 [dB SPL]			

Generell testinformasjon • Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll • Enheten drives i lineær modus • Lavnivåekspansjon er aktiv • Alle innhentede data måles med Phonak Target-måleinnstillinger

⚠ Advarsler Dette høreapparatet har et trykknivå for lydsignaler som kan overstige 132 dB SPL. Det må utvises spesiell forsiktighet ved tilpasning av dette apparatet da det er en risiko for nedsettelse av brukerens hørselsrest.

⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller høreapparatet.


* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lydmiljø.

Phonak Audéo P-R (P90/P70/P50/P30/Trial)


MAV Receiver 2 cm³ koblingsdata

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Output sound pressure level

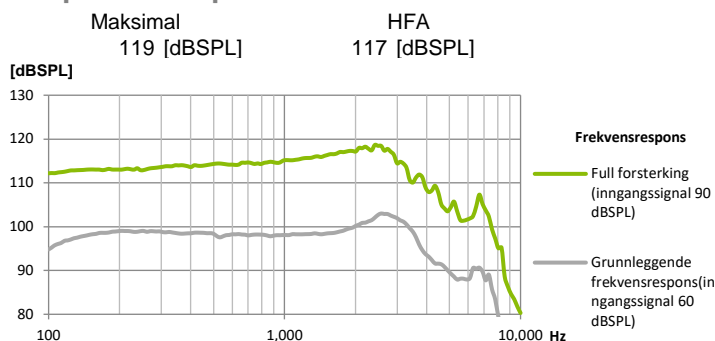

Acoustic gain

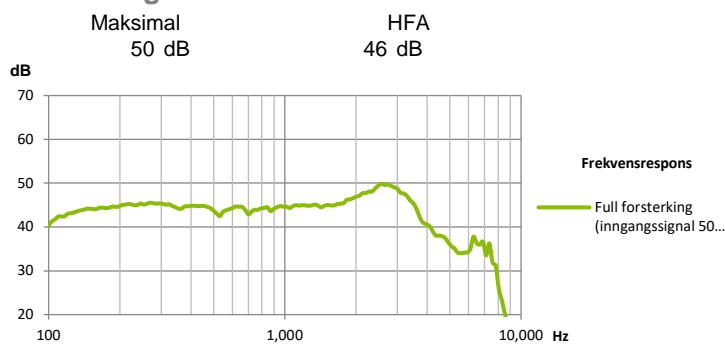


Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengni	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet driftstid*	18 h			
Tilsvarende tilført støynivå	19 [dB SPL]			


P-mottaker 2 cm³ koblingsdata

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Output sound pressure level

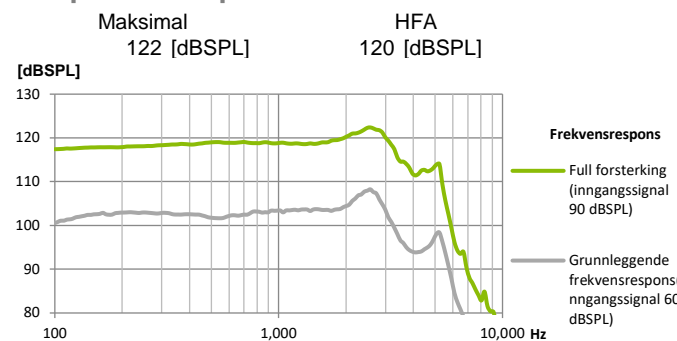

Acoustic gain

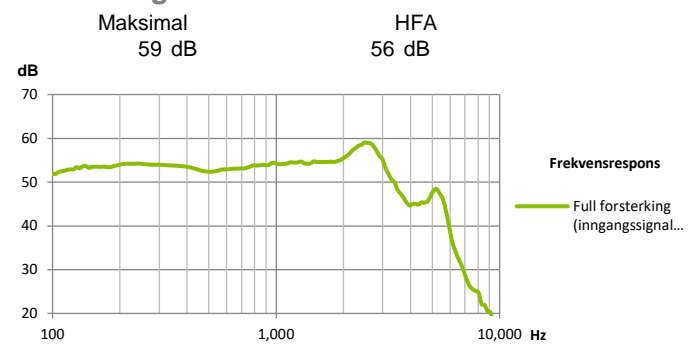

Frekvensområde	<100 Hz - 6300 Hz			
Total harmonisk forvrengni	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet driftstid*	18 h			
Tilsvarende tilført støynivå	19 [dB SPL]			


* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lyd miljø.

Phonak Audéo P-R (P90/P70/P50/P30/Trial)


UP-mottaker 2 cm³ koblingsdata

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Trykknivå for lydsignal

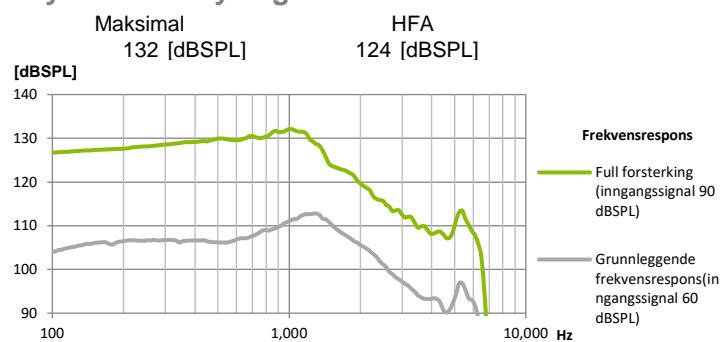

Lydforsterkning

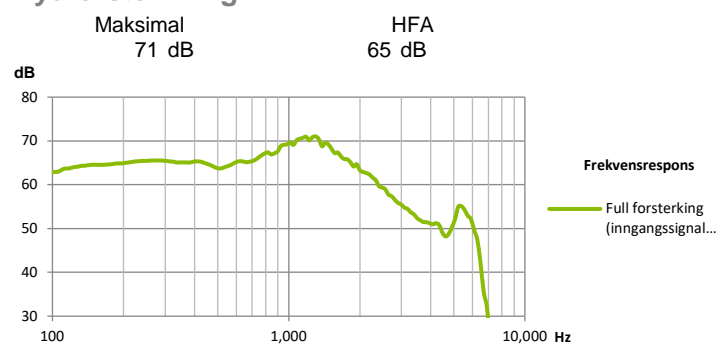

Frekvensområde	<100 Hz - 6100 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet driftstid*	18 h			
Tilsvarende tilført støynivå	19 [dB SPL]			

* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lydmiljø.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on