Bon de commande intra-auriculaires

Phonak Virto™ Marvel

*la vie s'exprime

PHONAK life is on*

2022-02 / Bon de commande Virto Marvel

Description des produits

		Virto M-Titanium M90/M70	Virto M-10 NW 0 M90/M70/M50	Virto M-312 NW 0 M90/M70/M50	Virto M-312 M90/M70/M50/M30
Bouton poussoir	Standard	Pas de bouton poussoir (PX)	Bouton poussoir (PM1)	Pas de bouton poussoir (PX)	Bouton poussoir (PM1)
	Option	Bouton poussoir (PM1)	Pas de bouton poussoir (PX)	Bouton poussoir (PM1)	-
Potentiomètre	Standard	-	Pas de potentiomètre (VCX)	Pas de potentiomètre (VCX)	Pas de potentiomètre (VCX)
	Option	-	Potentiomètre (VC3)	Potentiomètre (VC3)	Potentiomètre (VC3)
Bobine	Standard	Pas de capteur T (TX)	Pas de capteur T (TX)	Pas de capteur T (TX)	-
	Option	Capteur T passif (TP)	Capteur T passif (non disponible si potentiomètre)	Capteur T passif (non disponible si potentiomètre)	-
Switch magnétique	Standard	MiniControl (DT5)	EasyPhone (DT4)	EasyPhone (DT4)	-
	Option	EasyPhone (DT6)	MiniControl (DT3)	-	-
Pare-cérumen	Standard	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)
	Option	-	HF3 (H3), HF4 (H4), Ressort (WS), Tube long + Ressort (WE)	HF3 (H3), HF4 (H4), Ressort (WS), Tube long + Ressort (WE)	HF3 (H3), HF4 (H4), Ressort (WS), Tube long + Ressort (WE)
Fil d'extraction	Standard	Fil d'extraction transparent (RF)	Fil d'extraction transparent (RF)	-	-
	Option	-	-	Fil d'extraction transparent (RF)	Fil d'extraction transparent (RF)

Prise d'empreinte

Titanium FitGuide

Mesurez la profondeur d'insertion possible. L'appareil sera fabriqué conformément à la valeur FitGuide indiquée. Si la mesure se situe entre deux chiffres, veuillez utiliser le chiffre le plus petit.

Recommandations pour la prise d'empreinte

1. Utiliser EasyView Otoblock
2. Utiliser Dreve Otoform A softX 25 shore A
3. Remplir complètement la conque avec la pâte à empreinte
4. L'espace intertragal doit systématiquement être matérialisé sur l'empreinte, c'est à ce point que la mesure d'insertion du Titanium FitGuide doit être prise
5. La longueur de l'empreinte doit être au moins égale à la mesure prise avec le Titanium FitGuide

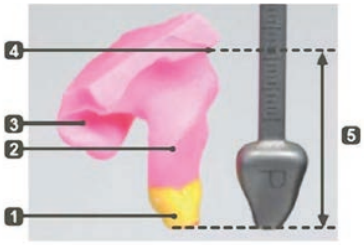

Utilisation d'EasyView Otoblock

- Se fixe au spéculum de l'otoscope
- La lentille fournit un retour visuel pendant l'insertion
- Placé directement devant le tympan

Disponible en 3 tailles :

- S - 054-0769 – 20 pcs
- M - 054-0768 – 20 pcs
- L - 054-0767 – 20 pcs

Plages d'application

Ecouteur M (40/109)* - Ecouteur P (50/115)*

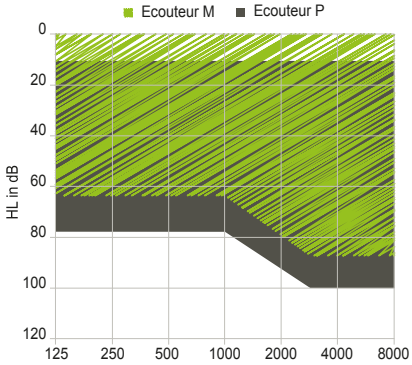

Ecouteur M : pertes auditives légères et moyennes (préconisé pour conserver des évents importants avec la meilleure esthétique)

Ecouteur P : pertes auditives moyennes à sévères (préconisé pour disposer d'appareils puissants avec évents de taille moyenne et l'esthétique la plus avantageuse)

* Valeurs de Gain et NS au 2cc

Ecouteur SP (60/119)* - Ecouteur UP (70/127)*

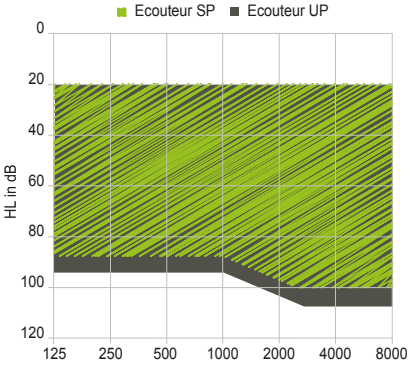

Ecouteur SP : pertes auditives sévères (préconisé lorsque la puissance est prioritaire, peut avoir un impact sur l'esthétique des appareils)

Ecouteur UP : pertes auditives profondes (préconisé lorsque la puissance est prioritaire, disponible uniquement sur demi-conque et conque)

* Valeurs de Gain et NS au 2cc

Contacts laboratoire sur-mesure
Tél. 04 72 14 50 00 / Email : laboratoire.intra@sonova.com

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques deposées appartenant a Bluetooth SIG, Inc.
L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.

Bon de commande Phonak Virto Marvel

Votre Centre

N° compte client : .....

Personne à contacter : .....

Tél : .....

Email : .....

Observations

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Référence Commande

Date de commande : ...../...../.....

Réf. Patient : .....

Age : .....

Email : .....

Sexe : ☐ Homme ☐ Femme

Appareillé : ☐ Oui ☐ Non

Texture de l'oreille : ☐ Souple ☐ Dure

Complément Stéréo : ☐ Oui ☐ Non

N° de série : .....
(pour un renouvellement Phonak ou un complément de stéréo)

Réduisez le délai de livraison

Sans instruction contraire de votre part, le laboratoire sur-mesure adaptera les paramètres de commande afin d'obtenir le meilleur compromis esthétique/performance et optimiser le délai en réduisant les pertes de temps liées aux échanges téléphoniques/emails.
Par exemple : adapter la fabrication de l'intra-auriculaire en fonction de la morphologie, adapter le modèle d'écouteur en fonction de la perte auditive, etc...

☐ NON, je souhaite être contacté pour toute modification (allongement du délai)

Audiométrie (impératif pour AOV)

	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	4000 Hz
OG dB						
OD dB						

Niveaux de performances

☐ **M90 Premium** ☐ **M70 Avancé** ☐ **M50 Standard** (Sauf Titanium) ☐ **M30 Essentiel** (Uniquement 312)

Choix intra-auriculaire (configuration standard, délai de traitement plus court)

Virto M-312

G D

HS / FS
Directionnel
Event AOV
Coque Noire

Wireless
Ecouteur M
Cerustop
Face Noire

Virto M-312 NW 0

G D

Mini Canal
Omnidirectionnel
Event AOV
Coque Beige

Non Wireless
Ecouteur M
Cerustop
Face Beige

Virto M-10 NW 0

G D

CIC / IIC
Omnidirectionnel
Event AOV
Coque R/B

Non Wireless
Ecouteur M
Cerustop
Face Cocoa

Virto M-Titanium

G D

CIC / IIC
Omnidirectionnel
Event AOV
Coque Titane

Non Wireless
Ecouteur M
Cerustop
Face Noire

Options de Commande

Couleurs Coques	☐ Rouge/Bleu (Std IIC/CIC)	☐ 21 Transparent	☐ 22 Cocoa	☐ 26 Beige	☐ 28 Marron ☐ 06 Noir (312 uniquement)
Couleurs Face-plate	☐ 22 Cocoa	☐ 26 Beige	☐ 28 Marron	☐ 06 Noir (sauf 312 NW 0)	
Évents	☐ AOV (Audiogramme imper.)	☐ AOV-0 (Titanium uniquement)	☐ Sans Évent	☐ Diamètre (mm) : OG :.....	OD :.....
Pare-Cérumen	☐ Cerustop (Std)	☐ HF3 (sauf Titanium)	☐ HF4 (sauf Titanium)	☐ Ressort (sauf Titanium)	☐ Tube long + Ressort (sauf Titanium)
Finitions	☐ Fil extraction (Std IIC/CIC)	☐ Fil d'extraction long (+5 mm)	☐ Rétention renforcée (Titanium uniquement)		
Écouteurs	☐ M	☐ P	☐ SP	☐ UP (312 seulement)	
Options	☐ Bouton poussoir	☐ Easy Phone (sauf 312)	☐ Potentiomètre (sauf Titanium)	☐ Capteur T	

Un forfait de fabrication sera appliqué pour toute annulation de commande effectuée 24h après enregistrement.
Usage interne/qualité empreinte(s) : B1 C1 C2 DE GI HO HE PI SU